

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/09/2019

AE

İlan No : 2019-09-3858
İstem No : 49624
Alım No :
Talep Eden Birim : ANESTEZİ ve REANİMASYON DEPOSU / Anestezi Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/09/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:4	20	Adet					
2	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:4.5	20	Adet					
3	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:5	20	Adet					
4	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:5.5	20	Adet					
5	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:6	20	Adet					
6	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:6.5	20	Adet					
7	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:7	30	Adet					
8	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:7.5	50	Adet					
9	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:8	50	Adet					
10	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:8.5	50	Adet					
11	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONSUZ, NO:4	20	Adet					
12	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONSUZ, NO:3.5	20	Adet					
13	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONSUZ, NO:4.5	20	Adet					
14	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONSUZ, NO:5	20	Adet					
15	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONSUZ, NO:5.5	20	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU, NO:4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Düşük basınçlı balona sahip olmalıdır.
2. Pilot balon olmalıdır.
3. Pilot balonun ucunda luer ve luer-lock enjektör giriş yeri olmalıdır.
4. Radyopak olmalıdır.
5. Nazal, oral kullanımına uygun olmalıdır.
6. Tüpün dış ucunda büyüklük ölçüleri yazılı olmalıdır.
7. Murphy gözü olmalıdır.
8. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
9. Latex içermemelidir.
10. Tüp I.D 4.0 mm , O.D en çok 7.1 ve uzunluk en az 240 mm olmalıdır.
11. Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU, NO:4.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Düşük basınçlı balona sahip olmalıdır.
- 2-Pilot balon olmalıdır.
- 3-Pilot balonun ucunda luer ve luer-lock enjektör giriş yeri olmalı
- 4-Radyopak olmalıdır.
- 5-Nazal, oral kullanımına uygun olmalıdır.
- 6-Tüpün dış ucunda büyüklük ölçüleri yazılı olmalıdır.
- 7-Murphy gözü olmalıdır.
- 8-Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
- 9-Latex içermemelidir.
- 10-Tüp I.D 4.5 mm , O.D en çok 7.6 ve uzunluk en az 265 mm olmalıdır.
- 11-Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU, NO:5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Düşük basınçlı balona sahip olmalıdır.
2. Pilot balon olmalıdır.
3. Pilot balonun ucunda luer ve luer-lock enjektör giriş yeri olmalıdır.
4. Radyopak olmalıdır.
5. Nazal, oral kullanımına uygun olmalıdır.
6. Tüpün dış ucunda büyüklük ölçüleri yazılı olmalıdır.
7. Murphy gözü olmalıdır.
8. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
9. Latex içermemelidir.
10. Tüp I.D 5.0 mm , O.D en çok 8.5 ve uzunluk en az 265 mm olmalıdır.
11. Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU, NO:5.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Düşük basınçlı balona sahip olmalıdır.
- 2-Pilot balon olmalıdır.
- 3-Pilot balonun ucunda luer ve luer-lock enjektör giriş yeri olmalıdır.
- 4-Radyopak olmalıdır.
- 5-Nazal, oral kullanımına uygun olmalıdır.
- 6-Tüpün dış ucunda büyüklük ölçüleri yazılı olmalıdır.
- 7-Murphy gözü olmalıdır.
- 8-Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
- 9-Latex içermemelidir.
- 10-Tüp I.D 5.5 mm , O.D en çok 9.0 ve uzunluk en az 265 mm olmalıdır.
- 11-Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

Prof. Dr. Nurcan DÖRÜK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. İes. No.: 51793

Yrd. Doç. Dr. Eminur SAGÜN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. İes. No.: 198761

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU, NO:6 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Düşük basınçlı balona sahip olmalıdır.
- 2-Pilot balon olmalıdır.
- 3-Pilot balonun ucunda luer ve luer-lock enjektör giriş yeri olmalıdır.
- 4-Radyoopak olmalıdır.
- 5-Nazal, oral kullanımına uygun olmalıdır.
- 6-Tüpün dış ucunda büyüklük ölçüleri yazılı olmalıdır.
- 7-Murphy gözü olmalıdır.
- 8-Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
- 9-Latex içermemelidir.
- 10-Tüp I.D 6.0 mm , O.D en çok 9.5 ve uzunluk en az 330 mm olmalıdır.
- 11-Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO: 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Düşük basınçlı balona sahip olmalıdır.
- 2-Pilot balon olmalıdır.
- 3-Pilot balonun ucunda luer ve luer-lock enjektör giriş yeri olmalıdır.
- 4-Radyoopak olmalıdır.
- 5-Nazal, oral kullanımına uygun olmalıdır.
- 6-Tüpün dış ucunda büyüklük ölçüleri yazılı olmalıdır.
- 7-Murphy gözü olmalıdır.
- 8-Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
- 9-Latex içermemelidir.
- 10-Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONSUZ, NO:3.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
- 2-Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
- 3-Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır
- 4-Nazal oral kullanımına uygun olmalıdır.
- 5-Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır
- 6-Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
- 7-Tüp I.D 3.5 mm ve O.D en çok 6.1 mm ve uzunluk en az 184 mm olmalıdır.
- 8-Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONSUZ, NO:4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
- 2-Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
- 3-Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
- 4-Nazal oral kullanımına uygun olmalıdır.
- 5-Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
- 6-Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
- 7-Tüp I.D 4.0 mm ve O.D en çok 6.8 mm ve uzunluk en az 185 mm olmalıdır.
- 8-Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONSUZ, NO:4.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
- 2-Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
- 3-Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
- 4-Nazal oral kullanımına uygun olmalıdır.
- 5-Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
- 6-Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
- 7-Tüp I.D 4.5 mm ve O.D en çok 7.3 mm ve uzunluk en az 195 mm olmalıdır.
- 8-Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

Prof. Dr. NURCAN DORUK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No.: 51793

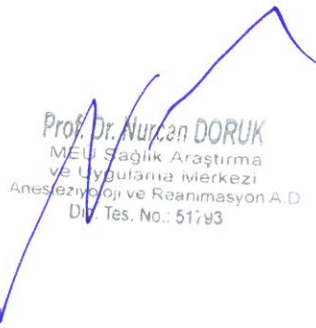
Yrd. Doç. Dr. ASİHUR SAGÜN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 125751

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONSUZ, NO:5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
4. Nazal oral kullanımına uygun olmalıdır.
5. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
6. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüp I.D 5,0 mm ve O.D en çok 8.0 mm ve uzunluk en az 195 mm olmalıdır.
8. Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONSUZ, NO:5.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
4. Nazal oral kullanımına uygun olmalıdır.
5. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
6. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüp I.D 5.5 mm ve O.D en çok 8.7 mm ve uzunluk en az 205 mm olmalıdır.
8. Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.


Prof. Dr. Nurcan DORUK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No.: 51793


Yrd. Doç. Dr. Asimur SAGUN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 125751