

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/11/2019

İlan No : 2019-11-4802
İstem No : 50718
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/11/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.25X10-12MM	15	Adet					
2	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.25X15-16MM	15	Adet					
3	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.25X7-9MM	10	Adet					
4	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.5MMX10-12MM	20	Adet					
5	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.5MMX15-16MM	15	Adet					
6	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.5MMX23-24MM	5	Adet					
7	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 3MMX15-16MM	15	Adet					
8	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.25MMX20-22MM	10	Adet					
9	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.25MMX24-25MM	5	Adet					
10	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.5MMX20-22MM	15	Adet					
11	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.75MMX16MM	15	Adet					
12	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 2.75MMX20-22MM	10	Adet					
13	STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK, 3MMX20-22MM	10	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

ESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI LACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İletişim: Tıbbat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

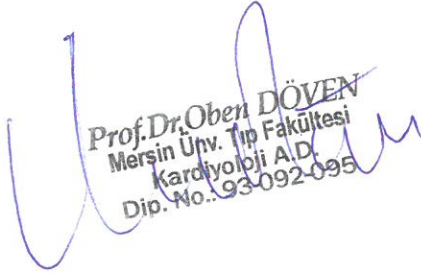
İmarat ÇUKUR

İmarat Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STENT, KORONER, BALONA MONTE, ÇIPLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stentin materyali Platinum Chromium olmalıdır.
2. Stent semi-compliant Dual-layer PEBAX™ Balloon materyelden yapılmış olup balon katetere üretici firma tarafından yüklenmelidir.
3. Balon katetere yüklü stent sisteminin proksimal proksimal şaft çapı 2.1 F, distal şaft çapı 2.7 F den yüksek olmamalıdır.
4. Kataterin ortalama stent profili 1.07 mm den fazla olmamalıdır.
5. Balon kataterin nominal basıncı 11 Atmosfere kadar olmalıdır. Rated burst pressure 2.25-3.0 mm çapındaki balonlar için 18 Atmosfer altında olmamalıdır.
6. Balon katetere yüklü stent sisteminin lezyon giriş profili 0.45mm den yüksek olmamalıdır.
7. Stent'in MR uyumlu olduğunu gösteren dökümanı olmalıdır.
8. Stent stratlarının kalınlığı maksimum 0.032 " veya altında olmalı ve birdirine ardışık iki konnektör ile bağlanmalıdır.
9. Balon katetere yüklü stent, 5 F guiding katater ile kullanılabilir.
10. Stentin recoil oranı 3.0x16 mm lik stent esas alındığında %3 ü geçmemelidir.
11. Stenti konumlandırmak için kullanılan marker lar esneklikten ödün vermemek için Platinum iridium olmalıdır.
12. Stent sisteminin distal şaftı kayganlığı artıracak ZGlide™ kaplamasına sahip olmalıdır.
13. Stentin metal arter oranı maximum %9 olmalıdır.
14. Stentin, olumlu sonuçları yanında, restenoz, MI, Kardiyak ölüm, erken ve geç tromboz verilerini (klinik performansını) gösteren kısa ve uzun dönem takip sonuçları ile ilgili klinik çalışmaları olmalıdır.


Prof. Dr. Öben DÖVEN
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip. No: 93092-095


Doç. Dr. Buğra ÖZKAN
M.E.U. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 126743