

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

18/03/2020

İlan No : 2020-03-1292
İstem No : 53080
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/03/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	NONABSORBE, MULTİFİLAMENT, İPEK, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:5/0, 10-13MM, 70-80CM	120	Adet					
2	NONABSORBE, MULTİFİLAMENT, İPEK, ATRAVMATİK, KESKİN, TEK İĞNE, NO:5/0, 11-13MM, 70-80CM	120	Adet					
3	ABSORBE, MULTİFİLAMENT, POLYGLACTİN VEYA LAKTOMER, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:1, 84-87MM, 80-95CM	120	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


İşdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

NONABSORBE, MULTİFİLAMENT, İPEK, ATRAVMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:5/0, 10-13MM, 70-80CM

1. CERRAHİ İPEK SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme ipekten, silikon kaplı ve multiflament yapıda olmalıdır.
2. Düğüm tutma özelliği yüksek, yumuşak ve ele gelişi kolay olmalıdır.
3. İstenilen nitelikte iğne ipliğe takılı olmalı, iğne – iplik birleşim yeri dokudan geçiş sırasında travma oluşturmamalıdır.
4. İğneler dokudan kolayca geçebilmeli ve çoklu geçişler için her geçişte aynı özelliği korumalıdır.
5. İplik kullanım sırasında filamanlarına ayrılmamalıdır. (tiftiklenmemelidir) ve kolay kopmamalıdır.
6. İğne suture uyumu bire bir olmalıdır.
7. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için çelik alaşımdan imal edilmelidir.
8. İğneler; görülebilir bir yerde, paket içinde sabit olmalıdır.



Doç. Dr. Hakan TAŞKINLAR
MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez
Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 106261-71597

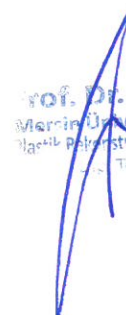

Dr. Öğr. Üyesi Caner İSMAIL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 134299 Uzm. Tes. No.: 103143

NONABSORBE, MULTİFİLAMENT, İPEK, ATRAVMATİK, KESKİN, TEK İĞNE, NO:5/0, 11-13MM, 70-80CM

2. CERRAHİ İPEK SÜTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme ipekten, silikon kaplı ve multiflament yapıda olmalıdır.
2. Düğüm tutma özelliği yüksek, yumuşak ve ele gelişi kolay olmalıdır.
3. İstenilen nitelikte iğne ipliğe takılı olmalı, iğne – iplik birleşim yeri dokudan geçiş sırasında travma oluşturmamalıdır.
4. Keskin iğneler ciltten kolayca geçebilmeli ve çoklu geçişler için her geçişte aynı özelliği korumalıdır.
5. İplik kullanım sırasında filamanlarına ayrılmamalıdır (tıftıklanmamalıdır) ve kolay kopmamalıdır.
6. İğne suture uyumu bire bir olmalıdır.
7. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için çelik alaşımdan imal edilmelidir.
8. İğneler; görülebilir bir yerde, paket içinde sabit olmalıdır.


Prof. Dr. Yavuz DEMİR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dip. Tes. No: 66950


Prof. Dr. Şakir ÜNAL
Marmara Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dip. Tes. No: 66950

**ABSORBE, MULTİFİLAMENT, POLYGLACTİN VEYA LAKTOMER,
ATRAVEMATİK, YUVARLAK, TEK İĞNE, NO:1, 84-87MM, 80-95CM**

3. SENTETİK MULTİFİLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN CERRAHİ SÜTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sentetik multifilament cerrahi iplik polyglaktin sınıfı olmalıdır.
2. Malzeme içeriği %90 poliglikolik asit + %10 polilaktik asit veya %100 poliglikolik asit türevi olmalıdır.
3. Emilebilen materyal olmalıdır.
4. Ortalama 3-4 hafta doku desteği sağlamalıdır.
5. Malzeme ortalama 8-9 haftada vücuttan tamamen atılmalıdır.
6. İstenilen nitelikte iğne ipliğe takılı olmalı, iğne – iplik birleşim yeri dokudan geçiş sırasında travma oluşturmamalıdır.
7. İğneler dokudan kolayca geçebilmeli ve çoklu geçişler için her geçişte aynı özelliği korumalıdır.
8. İplik kullanım sırasında filamanlarına ayrılmamalıdır (tiftiklenmemelidir) ve kolay kopmamalıdır.
9. İğne suture uyumu bire bir olmalıdır.
10. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için çelik alaşımdan imal edilmelidir.
11. İğneler; paket içinde görülebilir bir yerde ve sabit olmalıdır.

Prof. Dr. Haluk ÇAYIR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No.: 5649-60024

Prof. Dr. Mustafa Musa DİRLİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No.: 4889 2473 26272