

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/05/2020

İlan No : 2020-05-2013
İstem No : 53823
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM ONARIM

6A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/05/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	7	Adet					

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Gastroskop cihazı		
Gastroenteroloji Polikliniği Endoskopi Ünitesi	Marka :Pentax		
	Model : EG-290Kp		
	Seri No : H126920		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 14.05.2020	Var []	Yok [X]	Var []
		Yok [X]	Yok [X]

Açıklama; Cihaz görüntülemesini yapmamaktadır. Ayrıca hareket mekanizması ile kılıf kısmında zedelenmeler vardır. Cihazın bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 Adet Hareket Mekanizması
- 1 Adet Forseps kanalı
- 1 Adet Elastik Uç Kılıfı
- 1 Adet Kamera ön dış kılıfı

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Teknikeri	 Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hasan ÇELİK Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen

Açıklama	
----------	--


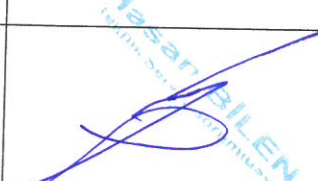
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Gastroskop cihazı	
	Marka :Fujinon	
Gastroenteroloji Polikliniği Endoskopi Ünitesi	Model : EG-250WR5	
	Seri No : LG202A015	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 14.05.2020	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Cihaz görüntü iletimini yapmamaktadır. Ayrıca hareket mekanizması ile forseps kanalı ve elastik uç kılıf kısmında zedelenmeler vardır. Cihazın bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 Adet Hareket Mekanizması
- 1 Adet Forseps kanalı
- 1 Adet Elastik Uç Kılıfı
- 1 Adet Kamera

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hasan BİLEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen

Açıklama	
----------	--

CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Gastroskop cihazı	
Gastroenteroloji Polikliniği Endoskopi Ünitesi	Marka :Fujinon	
	Model : EG-250WR5	
	Seri No : KG202A994	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 14.05.2020	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Cihaz yapılan kontrollerinde forseps kanalında kaçak olduğu ve görüntüsünde buğulanma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ön dış kılıf rubbercone altında katlanmalar olduğu tespit edilmiştir. Cihazın bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 Adet Forseps kanalı
- 1 Adet Elastik Uç Kılıfı
- 1 Adet Kamera
- 1 Adet Ön Dış Kılıf

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hakan BİLİR Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama	
-----------------	--


CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Gastroskop cihazı		
Gastroenteroloji Polikliniği Endoskopi Ünitesi	Marka :Pentax		
	Model :EG-290Kp		
	Seri No : G124145		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 14.05.2020	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Cihaz yapılan kontrollerinde forseps kanalında ile hava su kanalında kaçak olduğu ve kamerasının görüntü iletimini yapmadığı tespit edilmiştir. Cihazın bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 Adet Forseps kanalı
- 1 Adet Elastik Uç Kılıfı
- 1 Adet Kamera
- 1 Adet Hava-Su Kanalı

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hasan SÖZÜMLER Mersin Üniversitesi Hastanesi Başmüdür Yardımcısı

Açıklama	
-----------------	--



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Gastroskop cihazı	
	Marka :Pentax	
Gastroenteroloji Polikliniği Endoskopi Ünitesi	Model :EG-290Kp	
	Seri No : H126931	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 14.05.2020	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Cihaz yapılan kontrollerinde ön dış kılıfında ve arka dış kılıfında kırılma ile deforme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hareket mekanizması da arızalıdır. Cihazın bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 Adet Ön dış Kılıf
- 1 Adet Arka dış kılıf
- 1 Adet hareket mekanizması
- 1 Adet U-D Pull Assy
- 1 Adet L-R Pull Assy
- 1 Adet Elastik Uç Kılıfı

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Teknikeri	 Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hasan ÇELİK Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama	
----------	--


CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Gastroskop cihazı		
Gastroenteroloji Polikliniği Endoskopi Ünitesi	Marka :Fujinon		
	Model :EG-250WR5		
	Seri No : 6G202A599		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 14.05.2020	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Cihaz yapılan kontrollerinde hareket mekanizmasının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Cihazın bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 Adet Hareket Mekanizması
- 4 Adet DWA Telleri
- 1 Adet Elastik Uç Kılıf

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hasan KALKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker

Açıklama	
----------	--

CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Gastroskop cihazı		
Gastroenteroloji Polikliniği Endoskopi Ünitesi	Marka :Pentax		
	Model :EG-1690K		
	Seri No :A120316		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 14.05.2020	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Cihaz yapılan kontrollerinde forseps kanalı ve elastik uç kılıfında kaçak olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca görüntüsünün ve hareket mekanizmasının da arızalı olduğu tespit edilmiştir. Cihazın bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 Adet Hareket Mekanizması
- 1 Adet Kamera
- 1 Adet Elastik Uç Kılıf
- 1 Adet Forseps Kanalı
- 1 Adet U-D Pull Assy
- 1 Adet L-R Pull Assy

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan Dikman Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 Hasan Bilen Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama	
-----------------	--