

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2020

İlan No : 2020-01-37
İstem No : 51733
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Ürodinami
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ÜRODİNAMİ CİHAZI İÇİN SULU SİSTEM TRANSDUCER	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

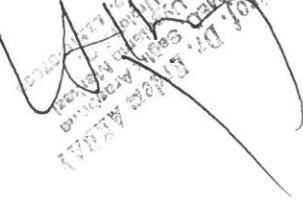
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BASINÇ MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Basınç Modülü tek parça olarak steril paketlenmiş olmalıdır.
2. Basınç Modülü üzerinde perfüzyon sistemi olmalıdır.
3. Basınç Modülü 2,5V excitation voltajına uyumlu olmalıdır.
4. Basınç Modülü -50 ile +500 cmH₂O arasında ölçüm yapmalıdır.
5. Basınç Modülünün bütün bağlantılarının kapakları olmalıdır.
6. Basınç Modülü bölümde mevcut olan cihaz ile uyumlu çalışmalı ve uygunluk alınmalıdır.
7. En az bir yıl raf ömrü olmalıdır.


Doç. Dr. Mehmet
N. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No: 107411


Doç. Dr. Mehmet
N. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No: 107411