

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

30/11/2022

İlan No : 2022-11-3760
İstem No : 67362
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI



Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/12/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HEMOROİD STAPLERİ, STARR TEKNİĞİNE UYGUN, 36MM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

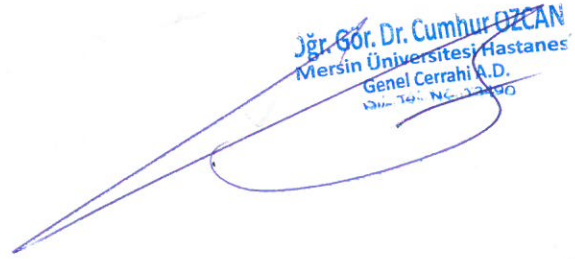
Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STARR MONOSTAPLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemoroid ve Spesifik olarak ODS (Obsrükatif Defekasyon Sendromu) ile kombine tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. STARR tekniğini bir stapler ile uygulamaya uygun olmalıdır.
3. Alet, aynı anda daire şeklinde çift sıra zımba atma ve iç dairenin ortasını da kesme işi yapabilmelidir.
4. Alet şaftı düz ve yüksek derece paslanmaz çelikten mamül olmalıdır.
5. Aletin kafa kısmı (anvil) şafttan ayrılmamalıdır.
6. Ateşleme işleminin tamamlandığını gösteren, cerrahın duyabileceği yükseklikte bir ses verme özelliği olmalıdır.
7. Aletin kesici bıçağı keskin ve Yüksek Volüm sağlamak üzere dairesel olarak yerleştirilmiş olmalıdır.
8. Alet distal haznesinin iç volümü Yüksek Volümlü ve en az 35,15mm³ olmalıdır.
9. Alet yuvasının derinliği en az 4,5cm olmalıdır.
10. Alet haznesi kolay görünür olmalı ve paraşüt tekniğine uygun sütürleri dışarıya çıkarıp askıda tutabileceğiniz geniş pencereye sahip olmalıdır.
11. Kullanılan zimbaların materyali titanyum olmalıdır.
12. Zımba eni en az 3.8mm, bacak uzunluğu en az 4.2mm, tel çapı en az 0.28mm olmalıdır.
13. Farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba yüksekliği 0.75mm ile 1.5mm arasında olacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır (kontrollü doku sıkıştırma özelliği ve maksimum hemostaz sağlamalı).
14. Alet tutacı üzerinde kapalı zımba yüksekliğinin o andaki durumunu gösteren ibrelili bir gösterge olmalıdır.
15. Aletin içindeki zımba sayısı en az 36 adet olmalıdır.
16. İstenmeden ateşlemenin önlenmesi için, tutaç üzerinde bir güvenlik kolu olmalıdır.
17. Alet dış çapı en az 36,5mm olmalıdır.
18. Dairesel bıçağın çapı en az 28 mm olmalıdır.
19. Alet yuvasının kenarlarında sütür geçirmek üzere dört adet kanal bulunmalıdır.


Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Mersin


J. Gör. Dr. Cumhuriyet ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Mersin