

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

05/04/2024

İlan No : 2024-04-1349  
İstem No : 74379  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2024 10:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORSEPS, KOAGÜLASYON, BİPOLAR, BAYONET, 0.5MM, 19CM	3	Adet					
2	FORSEPS, KOAGÜLASYON, BİPOLAR, BAYONET, 0.7MM, 19CM	3	Adet					
3	FORSEPS, KOAGÜLASYON, BİPOLAR, BAYONET, 0.3MM, 21CM	3	Adet					
4	FORSEPS, KOAGÜLASYON, BİPOLAR, BAYONET, 1MM, 16CM	3	Adet					
5	KABLO, BİPOLAR, YÜKSEK FREKANS, KBB KOAGÜLASYON PROBUNA UYUMLU	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdürü

### Bipolar Koagulasyon Forsepsi,

1. Teklif edilen bipolar forseps, yalıtılmış olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar forseps, bayonet şekilli olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar forseps, küt uçlu olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar forseps, ucu 0.5 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen bipolar forseps, 19 cm uzunluğunda olmalıdır.

### Bipolar Koagulasyon Forsepsi,

1. Teklif edilen bipolar forseps, yalıtılmış olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar forseps, bayonet şekilli olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar forseps, küt uçlu olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar forseps, ucu 0.7 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen bipolar forseps, 19 cm uzunluğunda olmalıdır.

### Bipolar Koagülasyon Forsepsi,

1. Teklif edilen bipolar forseps, yalıtılmış olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar forseps, bayonet şekilli olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar forseps, küt uçlu olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar forseps, ucu 0.3 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen bipolar forseps, 21 cm uzunluğunda olmalıdır.

### Bipolar Koagülasyon Forsepsi,

1. Teklif edilen bipolar forseps, yalıtılmış olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar forseps, bayonet şekilli olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar forseps, küt uçlu olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar forseps, ucu 1 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen bipolar forseps, 16 cm uzunluğunda olmalıdır.

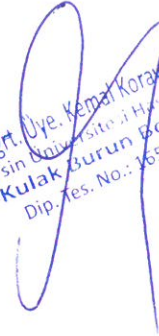
Teklif edilen bipolar koagulasyon forsepsleri ile birlikte 2 adet bipolar kablo verilmelidir.


Dr. Öğrt. Üye, Kemal Koray BAL  
Mersin Ünversitesi Hastane Si  
Kurtak Burun BOB 722  
Dip. Tes. No.: 165523

Dr. Öğrt. Üye, Kemal Koray BAL  
Mersin Ünversitesi Hastane Si  
Kurtak Burun BOB 722  
Dip. Tes. No.: 165523

**Bipolar Yüksek Frekans Kablosu,**

1-Teklif edilen bipolar yüksek frekans kablosu, bipolar koagulasyon forsepsleri ile kullanılmak üzere, 300 cm uzunluğunda olmalıdır.

  
Dr. Öğrt. Üye. Kemal Korak BAL  
Mersin Üniversite Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz  
Dip. Tes. No.: 165528

  
Prof. Dr. Kemal GÜRÜN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz A.B.D.  
Dip. Tes. No.: 161693