

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/04/2024

İlan No : 2024-04-1295
İstem No : 74462
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2024 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tes. Süresi (Gün)
1	STAPLER, ENDOSKOPİK, KESİCİ-KAPATICI, DÜZ, DİSPOSABLE	20	Adet					
2	STAPLER, ENDOSKOPİK, KESİCİ-KAPATICI, DÜZ, DİSPOSABLE, 16CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

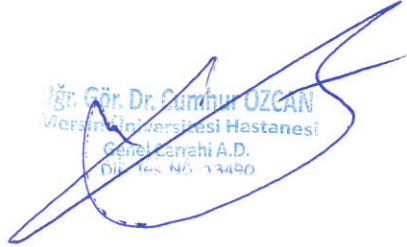
Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

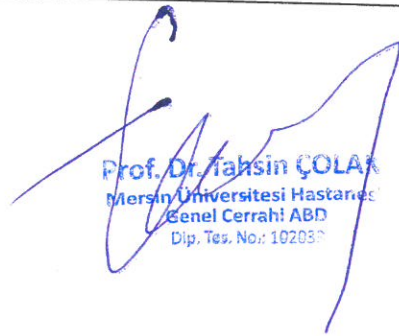
**SMT1547 STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPIK, GRASPİNG
ÖZELLİKLİ**

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında organ rezeksiyonu ve anastomoz sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Staplerin şaftının yükleme ünitesiz boyu; <ul style="list-style-type: none">• Kısa 6(\pm1) cm,• Orta 16cm(\pm2)• Uzun 26(\pm2) cm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Staplerde, ameliyat esnasında alet değişimini azaltmak için grasping fonksiyonu bulunmalıdır. 4. 30 veya 45 veya 60 mm'lik yükleme üniteleri aynı stapler ile kullanılabilir. 5. Staplerin handle üzerinde, ateşleme esnasında bıçağın nerede olduğunu gösteren 30-45-60 mm ibareli belirteç olmalıdır. 6. Stapler tutacının üzerinde, yükleme ünitesinin her iki yöne doğru 5'er adımda açıldırmanın sabitlendiğini teyit edecek şekilde, her adımda sesli geri bildirim vererek 45° kadar açılabilir mekanizması olmalıdır. 7. Staplerin şaftı 360° rotasyon hareketini yapmalıdır, 8. Stapler en az 12 kez ateşlenebilir özellikte olmalıdır. 9. Staplerin şaftının ucunda bulunan ok işareti sayesinde, yükleme ünitesinin şaft üzerine kolaylıkla kilitleme özelliğine sahip olmalıdır. 10. Staplerin handle üzerinde, ateşleme esnasında bıçağın nerede olduğunu gösteren 30-45-60 mm ibareli belirteç olmalıdır. 11. Stapler ile kullanılan yükleme ünitelerinin staplerden kolayca ayrılabilmesi için, yükleme butonunun şaftının ucunda veya rotasyon kolunun alt kısmında buton olmalıdır. 12. Stapler ile kullanılan yükleme ünitelerinin butonu üzerindeki renkli veya kilit belirteç sayesinde ünitenin doğru yüklendiği teyit edilebilir. 13. Stapler, rotasyon çentiklerinin bulunduğu yerde veya yükleme
Teknik Özellikleri:	

**SMT1547 STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK, GRASPİNG
ÖZELLİKLİ**

	<p>ünitesinin yerleştirildiği stapler şaftının ucunda yükleme ünitesinin şaft üzerinden çıkmasını engelleyen kilitleme mandalina veya butonuna sahip olmalıdır.</p> <p>14. Dokuya uygun yerleşim için, yükleme ünitesinin ilk tetiklemede çenesi kapanmalı, istenildiğinde staplerdeki metrik penceredeki mandallar geri çekilerek ateşleme olmaksızın tekrar dokuyu serbest bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır.</p> <p>15. Staplerde tutaç kapatılıp istenildiği anda ileri itilip veya mandal geri çekilerek pratik bir şekilde tekrar açılarak grasping özelliğini sağlamalıdır.</p> <p>16. Güvenlik açısından kontrollü ateşlemeyi sağlamak için, stapler sadece butona basılarak aktive edilebilmelidir.</p> <p>17. Tüm hat boyunca ideal "B" formasyonu sağlanabilmesi için, stapler her tetiklendiğinde kademeli olarak 15 mm kapama ve kesme yapma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik staplerin üzerindeki metrik pencereden takip edilebilmelidir.</p> <p>18. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı ile birlikte, çift sıralı üç hat boyunca kapama ve kesme yapmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>19. Ürün orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.</p>


İçr. Gör. Dr. Cumhuri UZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 13490


Prof. Dr. İhsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Dip. Tes. No: 10203